技术指导书（参考）

产品信息：

产品编码：2-4218-01

产品名：水分活度仪

型号：SP-W

产品部件介绍：

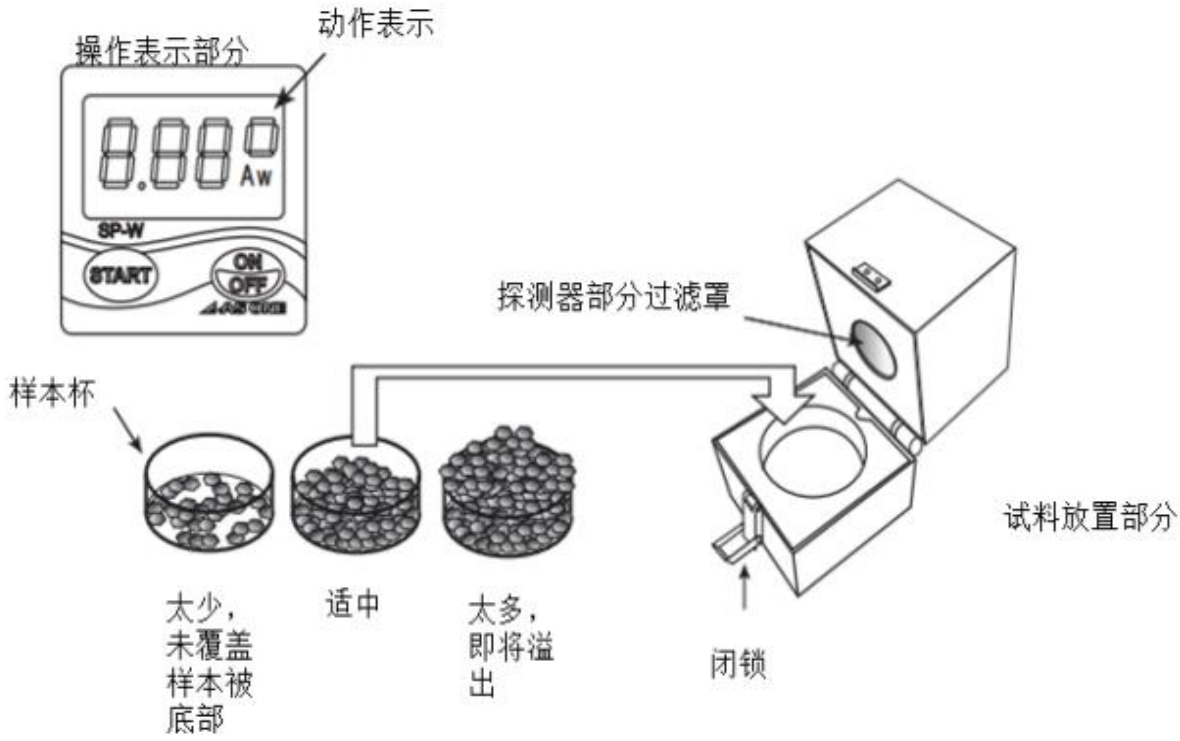

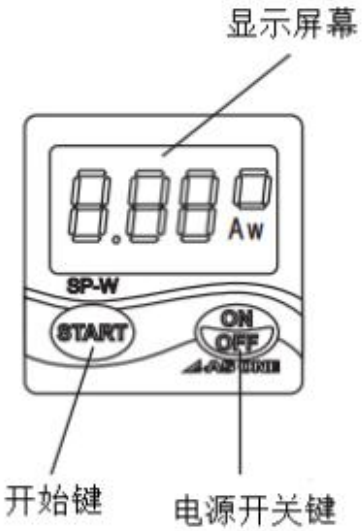

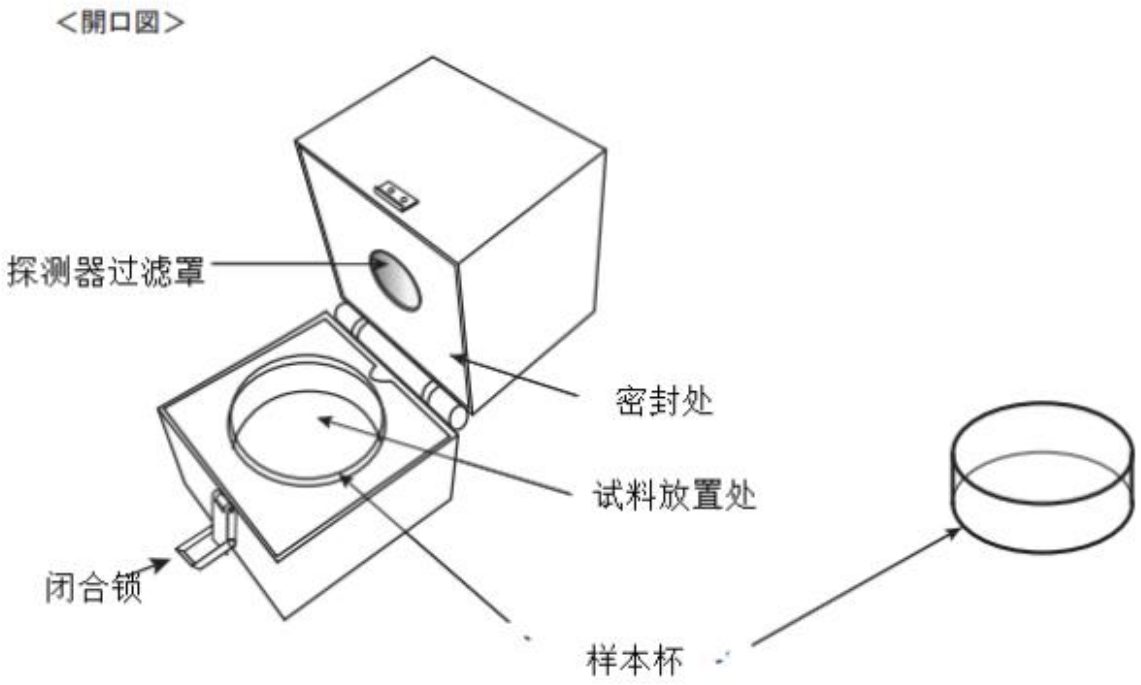

使用注意事项：

- 请在使用时参考图片中的试料放置量
- 请参考电池更换操作更换 CR2032 电池两枚
- 请勿将试料和电池长期滞留在本产品内部

QA:

- 关于探测器部分过滤罩

  当探测器部分过滤罩受污染时，会影响到探测器的正常工作，从而影响精度，故请定期检查并更换。

- 如何保持产品测试精度

  请定期使用水分活性测定装置校准液检查探测器精度。保证本产品在 25 度左右的环境下工作

电池的更换操作:

- 本产品电池型号为CR2032，数量为两枚，堆叠

1. 关闭本产品电源，确认试料仓为空，锁上闭合锁
2. 根据图1打开底盖（底盖固定方式为磁吸固定）
3. 取下旧电池(电池仓为CR2032纽扣电池两枚以堆叠方式收纳)(图2)
4. 安装新电池（请参考图三确认电池仓的电极，再参考电极示意图确认纽扣电池的正负极安装)
5. 关闭底盖，更换完成

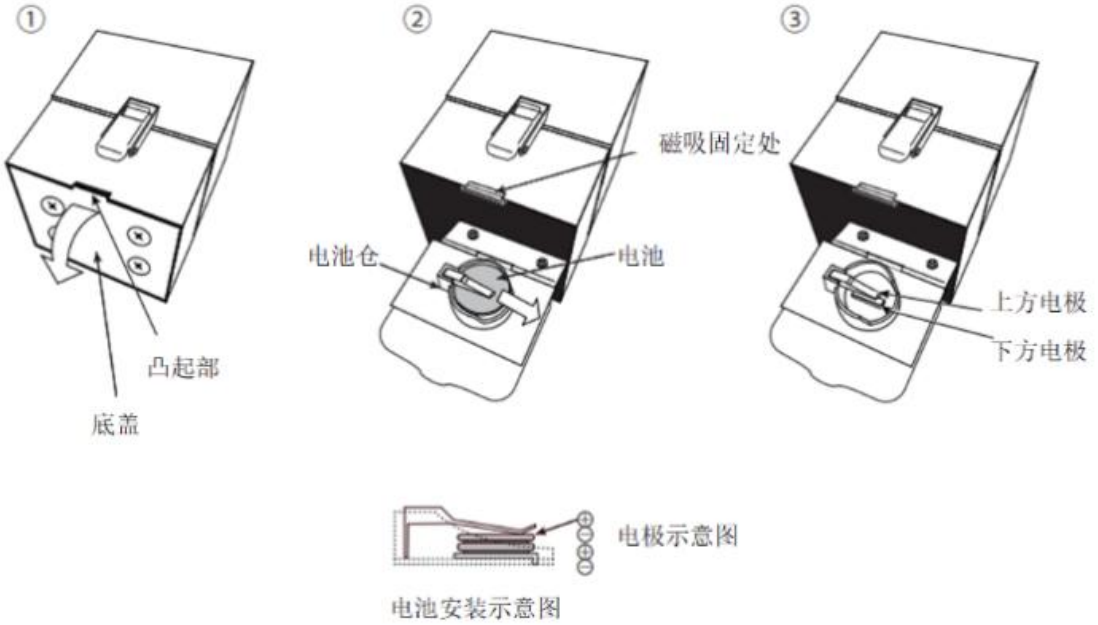

备注：

- https://axel.as-1.co.jp/asone/d/2-4218-01/movie/?page=0 产品电池更换和使用教程，过滤罩更换教程（需科学上网）