

## 使用说明书

## 废液回收器

型号 SF14-PW、SF14-CB、WT20-PW、WT20-CB



### 谢谢惠顾！

非常感谢您选购我们的产品。

为了您能够好地使用本产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书。

阅读后，请妥善保管好该手册，以备在使用过程中随时查阅相关操作说明。

当产品移交或转租时，请将本说明书附上，以便新使用者能正确安全地操作。

### 特征

●带浮子的漏斗可防止废液被过度填充。当约80%的容量时浮子会漂起。

●配有过滤器，以去除废液中的固体。

●接地型，可防止因静电引起的触电和火灾。

### 安装时请注意

●请勿暴露在热源下或受到阳光直射。

●请在通风良好的地方使用。

●请安装在一个平坦的表面上。


●请安装在附近没有高反应性物质的地方。

●请勿安装在人流量大的地方。

## 使用时请注意

- 使用时请戴上手套和护目镜等物品，以提供足够的保护。
- 请在5°C~40°C的环境温度范围内使用。建议使用温度为25°C。
- 请根据内部存放的液体，控制好储存时间。
- 如果使用了酸性或碱性物质，请事先充分稀释。
- 对有爆炸危险的废液请事先进行适当处理，在确认安全后再回收至容器。
- 请勿将固体放入容器中。
- 将本产品放在托盘等物品上使用时，请勿在一个托盘上放置两个以上的产品。由于液体溢出等原因，有可能发生反应，从而导致受伤。
- 请勿将本产品用于废液回收以外的任何用途。

## 各部分名称

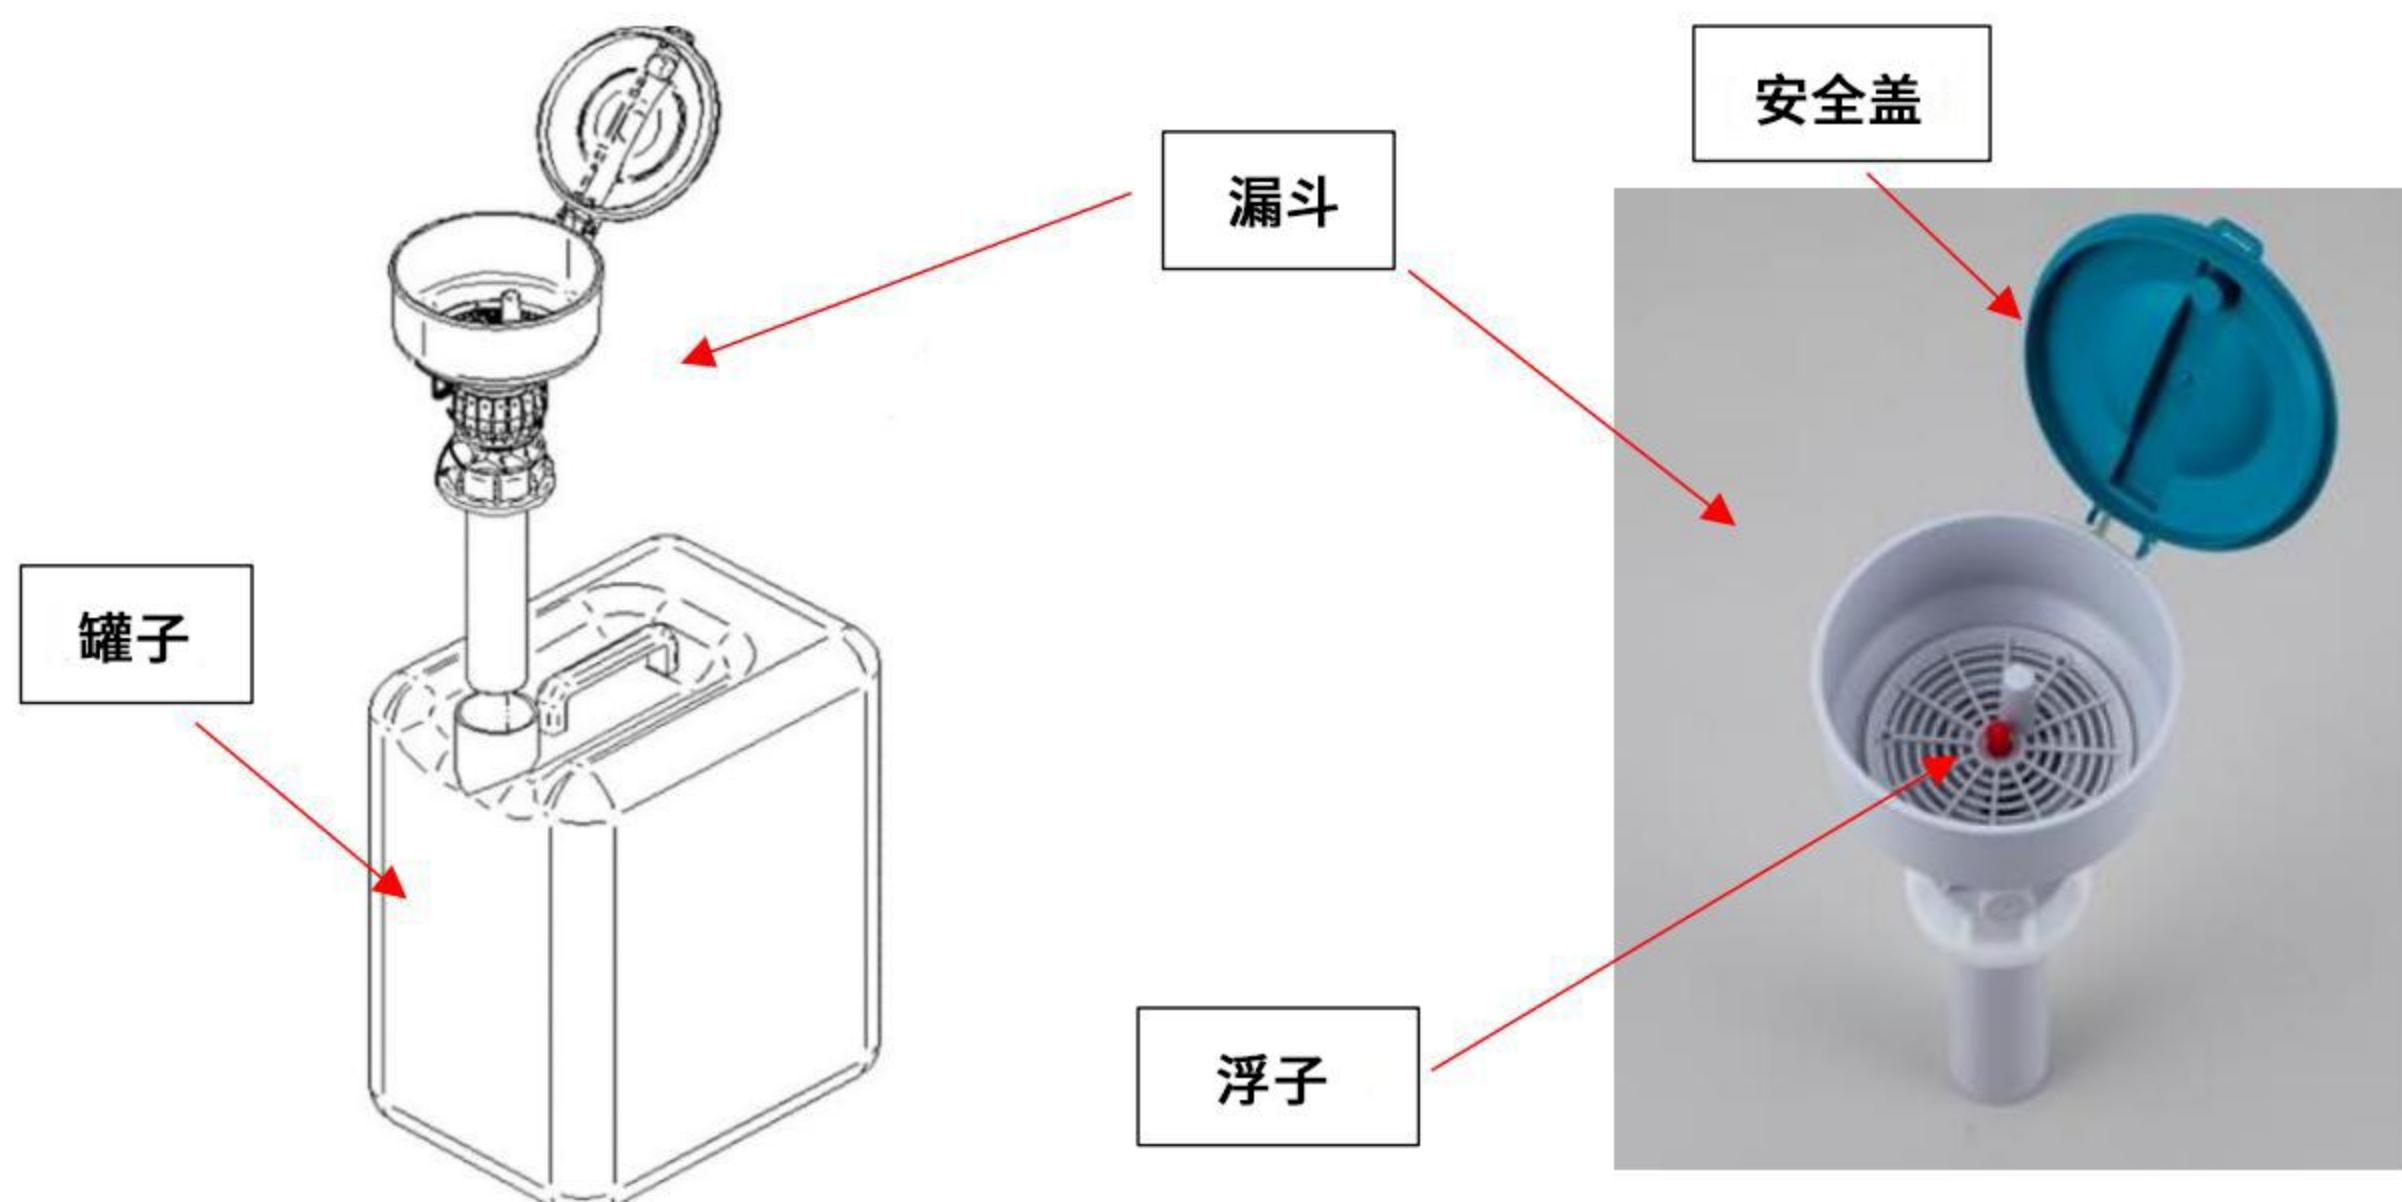

## 和主体一起捆包的物品

### 漏斗 (4-2537-01、02)

- 漏斗.....1个
- 70%液面杆...1根
- 内容物警告标签..1枚  
(请根据需要粘贴)
- 使用说明书 (本手册) ...1份
- 接地连接线...1根 (仅SF14-CB)

### 罐子 (4-2537-03、04)

- 罐子.....1个
- 内容物警告标签..1枚  
(请根据需要粘贴)
- 使用说明书 (本手册) ...1份

### 警告标签示例



## 参数

| 商品编号  | 4-2537-01           | 4-2537-02            | 4-2537-03     | 4-2537-04            |
|-------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 型号    | SF14-PW             | SF14-CB              | WT20-PW       | WT20-CB              |
| 规格    | 带浮子的漏斗<br>(静电扩散性样式) | 带浮子的漏斗<br>(静电扩散性样式)  | 罐子            | 罐子<br>(静电扩散性样式)      |
| 颜色    | 白色                  | 黑色                   | 白色            | 黑色                   |
| 尺寸    | 160×144×270mm       |                      | 228×301×402mm |                      |
| 材质    | PP                  |                      | HDPE          |                      |
| 容量    | 1L                  |                      | 22L           |                      |
| 表面电阻率 | -                   | 10 <sup>6</sup> Ω 以下 | 1             | 10 <sup>6</sup> Ω 以下 |
| 内径    | Φ 135mm             |                      | Φ 45mm        |                      |

※商品的规格及外观可能会因改良·改善而变更，恕不另行通知。

## 使用方法

- 1.请取下罐子的盖子，旋转漏斗以安装。
- 2.请打开漏斗顶部的安全盖，倒入废液。
- 3.当罐子容量的80%被填满时，浮球会上升。
- 4.旋转漏斗并拆下，并关闭罐子的盖子。
- 5.将装满废液的管子存放在一个合适的地方。



### 浮子液面杆的更换方法（使用4-2537-01、02时）

一般情况下，当倒入约容量80%的废液时，浮子会上升。

可以通过以下方法使其规格改变为70%时浮子上升。

- 1.首先逆时针旋转筛子和液面杆（红色部分），将其取出。
- 2.将液面杆从漏斗取下。
- 3.逆时针旋转浮子，将其从液面杆上取下。
- 4.将其与长度为230mm的70%液面杆更换，并按之前的相反顺序进行组装。




浮子



## **接地连接（使用4-2537-02、04时）**

1. 将螺丝穿过靠近漏斗外部中间的孔。（图1）
2. 将螺丝穿过接地连接线上的圆环。（图2）
3. 用端子夹住螺母，并牢固拧紧。（图3）
4. 请确保接地连接线的另一端正确接地。
5. 转动漏斗，确保它牢固地连接到罐子上。

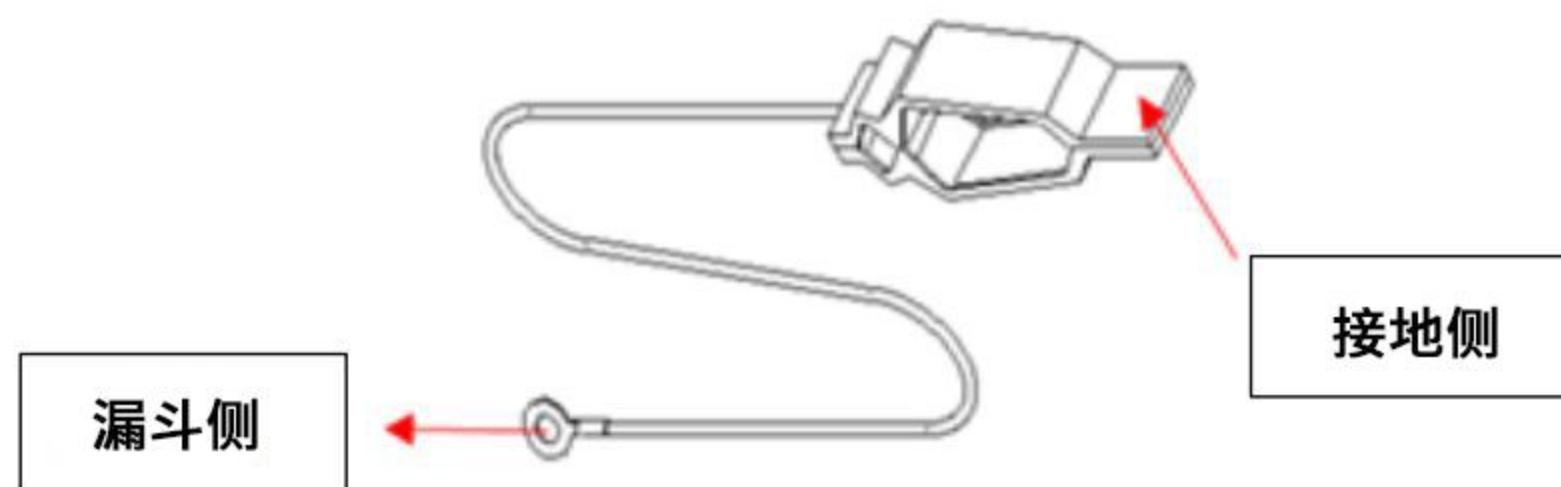


図①



図②



図③

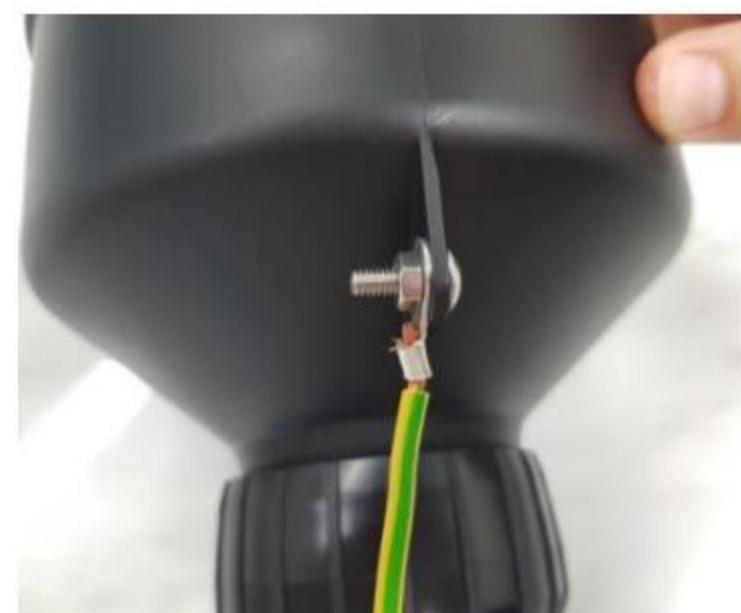

**AS ONE**

**亚速旺（上海）商贸有限公司**

**企业QQ：800050617**

**客服热线：021-54033266**

**邮箱：information@mail.as-1.cn**

**官方网站：<https://www.asonline.cn/>**

**2022年4月版**